
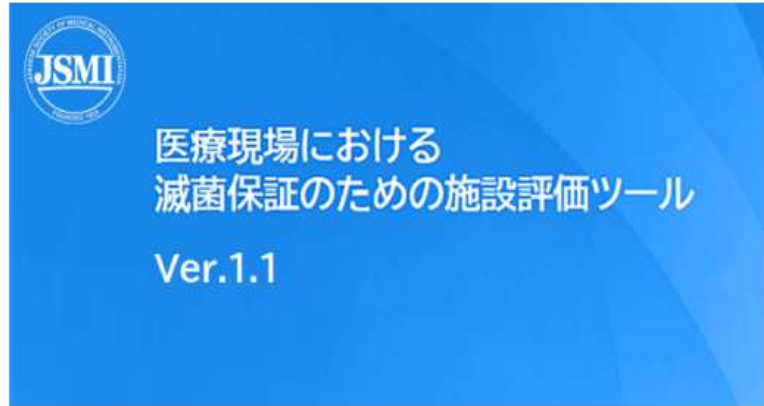



施設評価ツールにおける当院の滅菌業務採点結果は右のとおりです。
回答施設平均よりも上位の採点結果となっております。

課題にむけてさらなる業務改善・効率化を進めて参ります。

～ 滅菌物を使う医療者・使われる患者さんの安心と安全のために ～



領域別得点率

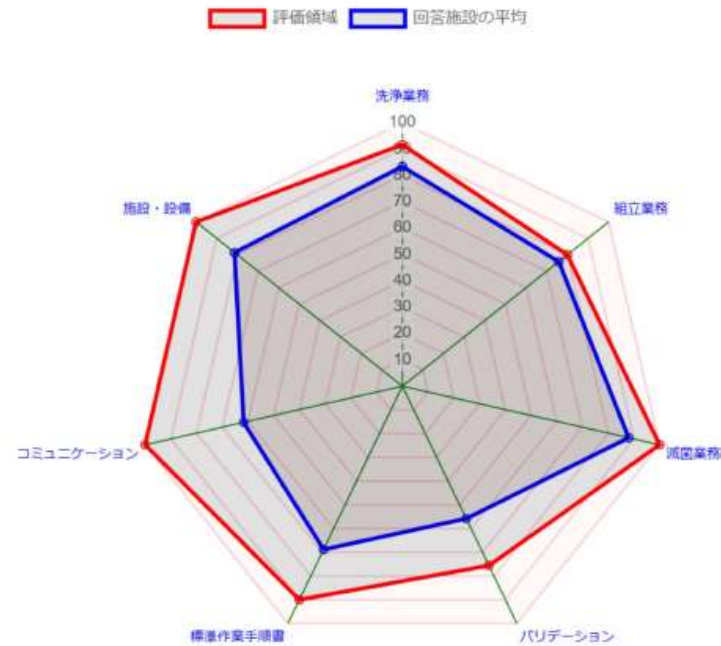

評価結果



総得点：124点 / 140点中
得点率：88.57

※「S」および「A」評価を取得するには設問44および設問56が必須項目となり、実施できていない場合は得点率を満たしていても最高評価は「B」になります。

回答日：2024/11/28
施設名：高知医療センター
回答者名：田中 拓子 様

洗浄業務	組立業務	滅菌業務	バリデーション	標準作業手順書	コミュニケーション	施設設備
11点 / 12点	8点 / 10点	15点 / 15点	31点 / 41点	27点 / 30点	25点 / 25点	7点 / 7点

施設評価ツール判定方法

この施設評価ツールは基本点を1点、加点点目を2点として集計します。また、施設により集計から除外する設問があり、満点変動するため、最終的な評価は得点率(以下の式を参照)を用いて判定します。

$$\text{※計算式} = \frac{\text{合計得点}}{\text{該当項目での満点}} \times 100 (\%)$$

判定	基準
S	90%以上
A	80%以上90%未満
B	70%以上80%未満
C	60%以上70%未満
D	60%未満